

สัญญาซื้อขายหัวกล้อง EK series

สัญญาเลขที่ ๑๙๙/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๓๕๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๓/๔ อาคารเดอain ทางเวอร์ อาคาร เอ ชั้น ๓๒ ถนนพระราม ๔ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นายมนตรี วรรณาทัศน์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงลงนามผูกพันนิติบุคคลประจำ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ E๑๐๐๘๑๒๐๑๐๘๖๙๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจช่วง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายหัวกล้อง EK series จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด เป็นราคารหั้งสิบ ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๗,๘๐๓.๗๔ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานอก ๑

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๔ (สี่),	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๗ (เจ็ด),	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง),	หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ ใบต่อรองราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	หน้า

ความได้ใน...

(ลงชื่อ).....*นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร* ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....*นายมนตรี วรรณาทัศน์*

(นายมนตรี วรรณาทัศน์)

ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด



ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งทึบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบท้ายที่ต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจสอบ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณี...

(ลงชื่อ).....mvf.....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....mr. J.A......ผู้ขาย

(นายมนตรี วรรณาทัศน์)

ผู้รับมอบอำนาจจากช่วงจาก

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด



ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยู่ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๔/๐๗๓๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๔,๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคารถทั้งหมดตามสัญญา นามอปเป้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปเป้ให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปเป้ให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง นามอปเป้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปเป้ไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการนี้...

(ลงชื่อ).....*mfc*.....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....*M.R.A*.....ผู้ขาย

(นายมนตรี วรรณุทัศน์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด



ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิ์รับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคากลางที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญานั้นที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ทดลองซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้มิสามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้อภิว่ายังไม่ได้ส่งมอบ สิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยัง ผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้อง ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงด...

(ลงชื่อ).....นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์ชัยวัฒน์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....นายมนตรี วรรณุทัศน์ ผู้ขาย

(นายมนตรี วรรณุทัศน์)

ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด



ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่มั่นใจว่าต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้ขายมีสิทธิของดังกล่าวเพื่อให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรือน้ำอื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบไปตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาไปตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้...

(ลงชื่อ).....นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร.....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ ประจวบตราชาระฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....นายมนตรี วรรณทัศน์.....ผู้ขาย

(นายมนตรี วรรณทัศน์)
ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทท์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ




(ลงชื่อ)  ผู้ขาย

(นายมนตรี วรรณฤทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวสายชล ชุมธรวิชรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  พยาน


(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)


นิติกร


เอกสารประกอบสัญญาซื้อขาย
หัวกล้อง EK series
จำนวน ๑ ชุด


ประกอบด้วย

๑. รายการคุณลักษณะเฉพาะ
๒. แค็ตตาล็อก
๓. ใบเสนอราคา บริษัท ออลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
๔. ใบต่อรองราคา

(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ
(นายสมพักดี ชิรรัพย์สถาพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย
(นายมนตรี วรรณุทัศน์)
ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก
บริษัท ออลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด


(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสายชล ธัญรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)
นิติกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หัวกล้อง 4K series

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นหัวกล้องส่องตรวจแบบความคมชัดสูงระดับ 4K ใช้เชื่อมต่อเข้ากับชุดประมวลผลสัญญาณภาพเพื่อรับภาพจากเลนส์แปลงสัญญาณภาพ แล้วทำการแสดงภาพออกจากจอモニเตอร์ ขณะทำการผ่าตัดผ่านกล้อง

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ หัวกล้อง 4K (Camera Head 4K) จำนวน ๑ อัน

๒.๑.๑ มีตัวรับสัญญาณภาพเป็นชนิด 4K Exmor R CMOS sensor

๒.๑.๒ มีระบบ One-Touch Auto Focus

๒.๑.๓ รองรับความละเอียดภาพคุณภาพแบบ 4K

๒.๑.๔ ระยะโฟกัสภาพไม่น้อยกว่า ๒๓.๕ มม.

๒.๑.๕ มีปุ่มควบคุมหัวกล้อง ๓ ปุ่ม สามารถตั้งค่าได้

๒.๑.๖ รองรับการส่องตรวจแบบใช้คลื่นแสง NBI (NBI Observation mode)

๒.๑.๗ มีระบบ Electronic Zoom

๒.๑.๘ สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยการเช่น้ำยา และ V-Pro และ Sterrad, ETO และ Autoclave ได้

๒.๒ เลนส์ส่องตรวจ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. ทิศทางมองภาพไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา จำนวน ๑ ชิ้น

๒.๒.๑ มุ่มนองภาพไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา

๒.๒.๒ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำกล้องขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๓ สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้

๒.๒.๔ มีฟังก์ชัน ED glass lens เพื่อช่วยให้ภาพที่แสดงมีความคมชัดยิ่งขึ้น

๒.๓ สายนำแสง จำนวน ๑ เส้น

๒.๓.๑ เป็นสายนำแสงชนิดใยแก้วนำแสง (Fiber)

๒.๓.๒ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า ๔.๒๕ มิลลิเมตร

๒.๓.๓ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร

๒.๓.๔ สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๓.๑ กล้องบรรจุหัวกล้องส่องตรวจ จำนวน ๑ กล้อง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการสาอิฐหรือถูกใช้งานมาก่อน

๔.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันรับเครื่องเป็นต้นไป โดยเฉพาะอันเกิดจากการผลิตในโรงงาน

๑. นายธนวัฒน์ เต็งศิริโภล
๒. นางวิไลวรรณ อาจานนรงค์
๓. นางสาวปาริชาติ ป่าเกลือ

.....
.....
.....



MMYAT

๔.๓ จะต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องมือทุก ๔ เดือน ตลอดระยะเวลาการรับประกัน ๒ ปี และสอบเทียบเครื่องมืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จนหมดระยะเวลาประกันพร้อมออกใบรับรองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๔ ในระยะเวลา.rับประกันหากทางโรงพยาบาลแจ้งเครื่องเสียเบี่ยงผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งซ่อมเข้ามาตรวจเช็คภายใน ๒๔ ชั่วโมง และหากไม่สามารถซ่อมได้ภายใน ๗ วัน จะต้องนำเครื่องสำรองมาให้โรงพยาบาลใช้จนกว่าจะซ่อมเสร็จ นับตั้งแต่วันที่รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่มีคุณลักษณะเดียวกันให้ ภายใน ๙๐ วัน

๔.๕ มีช่างวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลผู้ผลิตโดยตรงในการให้บริการหลังการขาย

๔.๖ สามารถใช้งานร่วมกับ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความคมชัดสูง ๔K ที่มีอยู่เดิมในโรงพยาบาลได้

๔.๗ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้อย่างน้อย ๑ ชุด

๕. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

ส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย


๖. วงเงินงบประมาณที่จะซื้อ

จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นายธนวัฒน์ เต็งศิริโภล)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางวีลาวรรณ อาจานวงศ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวปาริชาติ ป่าเกลือ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ





OLYMPUS

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หัวกล้องส่อง 4K serise

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นหัวกล้องส่องตรวจแบบความคมชัดสูงระดับ 4K ใช้ชื่อต่อเข้ากับชุดเครื่องประมวลผลสัญญาณภาพ เพื่อรับภาพจากเลนส์แปลงสัญญาณภาพ แล้วทำการแสดงภาพออกจากจอモニเตอร์ขณะทำการผ่าตัดผ่านกล้อง

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1. หัวกล้อง 4K (Camera Head 4K)

จำนวน 1 อัน

- 2.1.1 มีตัวรับสัญญาณภาพเป็นชนิด 4K Exmor R CMOS sensor
- 2.1.2 มีระบบ One-Touch Auto Focus
- 2.1.3 รองรับความละเอียดภาพคุณภาพแบบ 4K
- 2.1.4 ระยะโฟกัสภาพ 23.5 มม.
- 2.1.5 มีปุ่มควบคุมหัวกล้อง 3 ปุ่ม สามารถตั้งค่าได้
- 2.1.6 รองรับการส่องตรวจแบบใช้คลื่นแสง NBI (NBI Observation mode)
- 2.1.7 มีระบบ Electronic Zoom
- 2.1.8 สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยการแข็งน้ำยา และ V-Pro และ Sterrad, ETO และ Autoclave ได้

2.2. เลนส์ส่องตรวจ ขนาด 10 มม. ทิศทางมองภาพ 30 องศา

จำนวน 1 ชิ้น

- 2.2.1. มุ่มมองภาพ 30 องศา
- 2.2.2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำกล้องขนาด 10 มิลลิเมตร
- 2.2.3. สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
- 2.2.4. มีฟังก์ชั่น ED glass lens เพื่อช่วยให้ภาพที่แสดงมีความคมชัดยิ่งขึ้น

2.3. สายน้ำแสง

จำนวน 1 เส้น


- 2.3.1. เป็นสายนำแสงชนิดไนเก็บร้อน (Fiber)
- 2.3.2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสาย 4.25 มิลลิเมตร
- 2.3.3. มีความยาว 300 เซนติเมตร
- 2.3.4. สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1. กล้องบรรจุหัวกล้องส่องตรวจ จำนวน 1 กล้อง

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการสาธารณูปโภคใช้งานมาก่อน

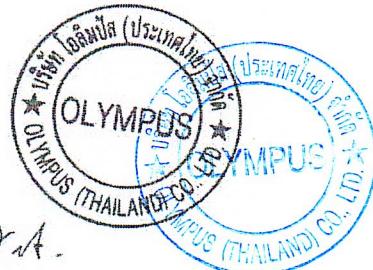


OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD.

33/4 The Ninh Towers, Tower A, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand Tel +66 2000 7700 Fax +66 2000 7711

M.Y.A.

OLYMPUS

- 4.2 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันรับเครื่องเป็นต้นไป โดยเฉพาะอันเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตในโรงงาน
- 4.3 จะต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องมือทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี และสอบเทียบเครื่องมืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จนหมดระยะเวลาประกันพร้อมออกใบรับรองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 4.4 ในเวลา.rับประกันหากทางโรงพยาบาลแจ้งเครื่องเสียไปยังบริษัท ทางบริษัทต้องส่งซ่่างเข้ามาตรวจเช็คภายใน 24 ชั่วโมง และหากไม่สามารถซ่อมได้ภายใน 7 วัน จะต้องนำเครื่องสำรองมาให้โรงพยาบาลใช้จนกว่าจะซ่อมเสร็จ นับตั้งแต่วันที่รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ บริษัทต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่มีคุณลักษณะเดียวกันให้ ภายใน 90 วัน
- 4.5 มีซ่างวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงในการให้บริการหลังการขาย
- 4.6 สามารถใช้งานร่วมกับ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความคมชัดสูง 4K ที่มีอยู่เดิมในโรงพยาบาลได้
- 4.7 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้

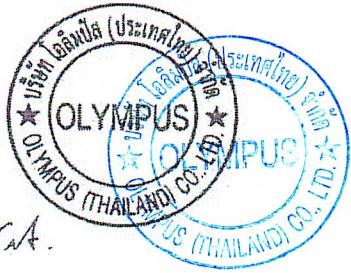

OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD.

33/4 The Ninth Towers, Tower A, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand Tel +66 2000 7700 Fax +66 2000 7711

M.Y.A.

OLYMPUS

VISERA
4K UHD

4K AUTOCLAVABLE CAMERA HEAD/4K CAMERA HEAD

2.1. CH-S400-XZ-EA/EB

Clear Image in Every Condition



CH-S400-XZ-EA/EB


2.1.1

Sharper Images with Less Noise with the 4K Exmor R® CMOS Sensor and Optical-Fiber Transmission

- High sensitivity
- Less noise (dual noise-reduction function)
- No delay (4K high-speed transmission) **2.1.3**

Optimal View (Fast and Accurate)

- 2.1.2**
- One-Touch Auto Focus function always enables surgeons to see the fine details of tissue/texture
 - Electronic zoom allows surgeons to observe the fine patterns and structures of tissues in the body – in high precision even when enlarged

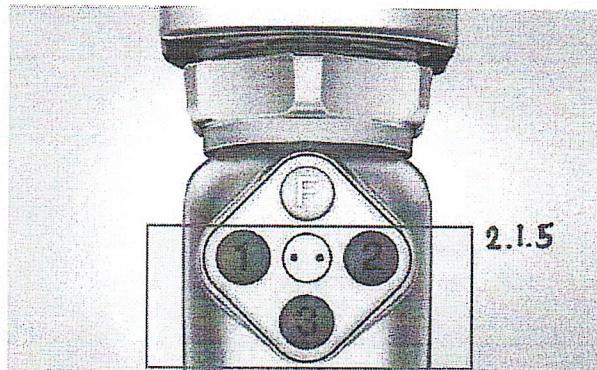

Improved Operability (Ergonomic Design)

- Small, compact camera head
- New coupler design



V-Pro Compatibility

Autoclave Compatibility (CH-S400-XZ-EA only)

- Reduced costs compared with other sterilization methods

Innovation by
Sony & Olympus



Specifications

	CH-400-XZ-EA	CH-400-XZ-EB
Order Number	N5404730	N5401730
Size	 Camera head dimensions (unit: mm) Total length: 122.5 mm Head width: 46 mm Head height: 49.5 mm	 Total length: 122.5 mm Head width: 46 mm Head height: 49.5 mm
Observation	 Pickup system: CMOS image sensor Focal length: f = 23.5 mm 2.1.4 NBI observation mode*: Available 2.1.6 Records of camera head information*: Available Electronic shutter function*: Available 2.1.7 Electronic zoom function*: Available	
Cleaning/Disinfection/Sterilization	 Cleaning/disinfection: 2.1.8 Immersible in disinfectant solution Sterilization: Autoclavable/V-Pro/ETO/Sterrad	V-Pro/ETO/Sterrad
Classification (electro-medical equipment)	 Degree of protection against electric shock: TYPE BF Degree of protection against explosion: The camera head should be kept away from flammable gases	

* For more details, refer to the instruction manual for the OTV-S400.
As medical knowledge is constantly growing, technical modifications or changes of the product design, product specifications, accessories and service offerings may be required.

OLYMPUS

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
Postbox 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany
Wendenstrasse 20, 20097 Hamburg, Germany
Phone: +49 40 23773-0, Fax: +49 40 233765
www.olympus-europa.com




EU692365 07/21 - OEGG

OLYMPUS

2.2

5.4 AND 10 MM ULTRA TELESCOPES


Optimized for a High Resolution Image.

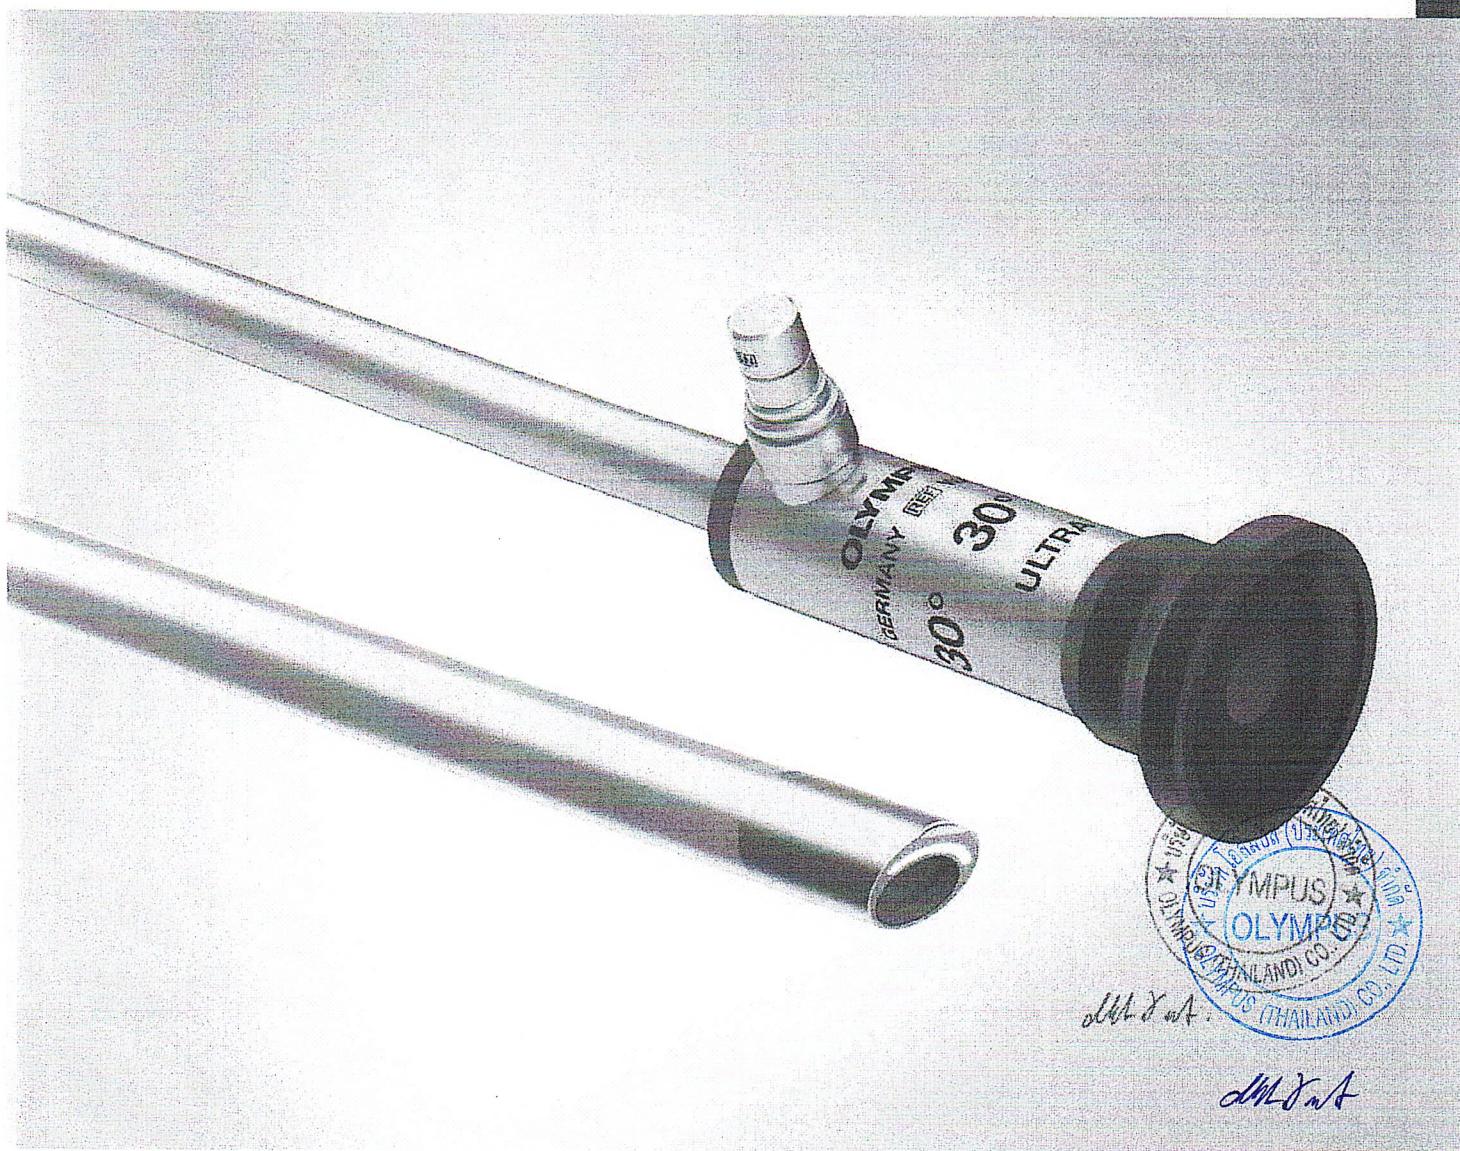

5.4 AND 10 MM ULTRA TELESCOPES


ED Glass Lenses – Razor-Sharp Images

- Optimized for high-resolution imaging **2.1.4.**
- High contrast at high spatial frequencies
- Comparable working length for 5.4 mm and 10 mm

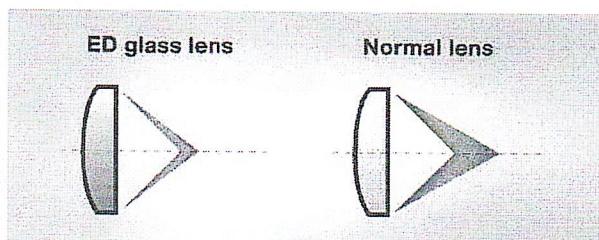

Distortion-Free Images (5.4 mm telescope)

- Clear images even at the edges
- No barrel or pincushion distortion (using 5.4 mm telescope)

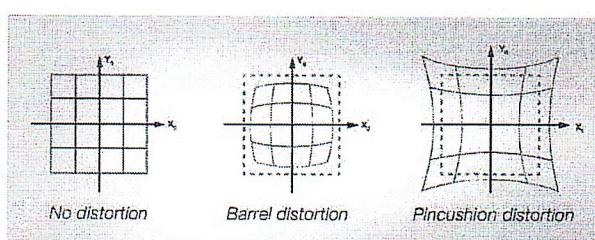

Wide Field of View

- Visual field increased by 20% compared to conventional HD endoscopes*

Full Autoclavability **2.1.3**

- Reduced waste due to full reusability of the telescopes



Compatibility

- Mechanical compatibility to current generations of camera heads and light guide cables by Olympus and other manufacturers that comply with DIN58105.

Good Illumination Even at the Edges

- The ULTRA telescopes have a homogeneous light distribution in the peripheral region (both 5.4 mm and 10 mm)

* 5.4-mm ULTRA telescope compared to endoscope with 70° field of view and 10mm ULTRA telescope compared to endoscope with 75° field of view.

Ordering Information

Order Number	Outer Diameter	Direction of View (DOV)	Working Length	Max. Insertion Portion Width
WA4KL500	5.4 mm	0°	315.3 ± 0.5 mm	5.45 mm
WA4KL530	5.4 mm	30°	315.5 ± 1.5 mm	5.45 mm
WA4KL545	5.4 mm	45°	315.5 ± 1.5 mm	5.45 mm
WA4KL100	10 mm	0°	315.9 ± 0.5 mm	10.2 mm
WA4KL130	10 mm 2.1.1	30° 1.1.1	317.1 ± 1.5 mm	10.2 mm
WA4KL145	10 mm	45°	317.7 ± 1.5 mm	10.2 mm

Specifications

Operating Conditions	Ambient temperature	10 to 35°C (50 to 95°F)
	Relative humidity	30 to 85%
	Atmospheric pressure	700 to 1060 hPa
Storage Conditions	Temperature	10 to 40°C (50 to 104°F)
	Relative humidity	30 to 85%
Transport Conditions	Temperature	-40 to 70°C (-40 to 158°F)
	Relative humidity	10 to 95%

Specifications, design, and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

OLYMPUS

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
Postbox 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
Phone: +49 40 23773-0, Fax: +49 40 233765
www.olympus-europa.com

ML Y.A.

ML Y.A.






OLYMPUS

Your Vision, Our Future

2.3

LIGHT GUIDE CABLES

Eco-friendly and durable

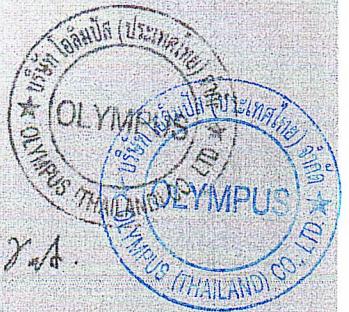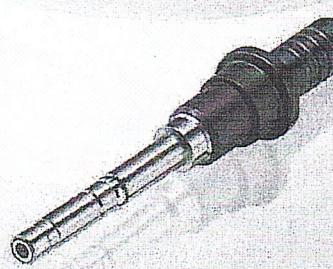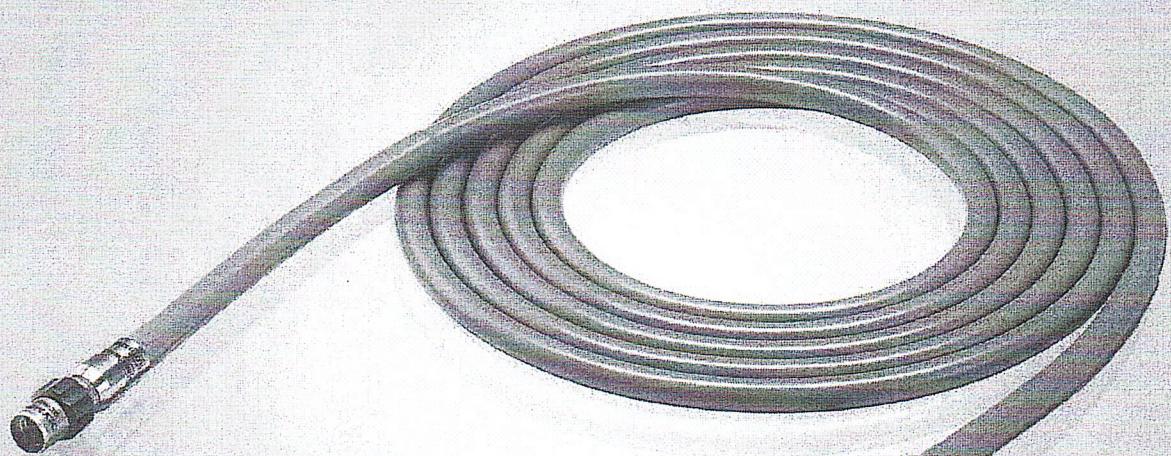

MM.YA

MM.YA


OPTIMAL LIGHT TRANSMISSION

Ensuring you have a good view can be the key to success – and this particularly applies to endoscopic procedures.

Olympus light guide cables mean you can focus on your day-to-day work, and not have to worry about light being correctly transmitted.

When combined with an Olympus light source and the required scope, you'll benefit from optimal illumination to suit your needs.


- Eco-friendly in terms of RoHS compliance
- CF applied part classification for use in cardiac surgery
- Optimal light transmission thanks to fused optical fibers **2.3.1**
- Durability: optimized tube and fused fiber bundles for extremely high durability against mechanical stress and autoclaving
- High temperature resistance
- Compatible with a wide variety of endoscopes if used with suitable adapters
- Autoclavable **2.3.4**

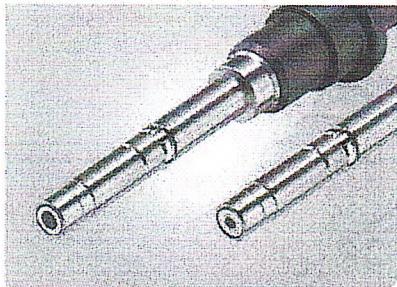

Specifications


Delivery of all light-guide cables includes light-guide adapter WA03320A.

WA03300A Light-guide cable, 2.8 mm, 3 m, CF type



maximum insertion portion width of the endoscope ≤ 4.1 mm

WA03310A Light-guide cable, 4.25 mm, 3 m, CF type



maximum insertion portion width of the endoscope > 4.1 mm


Spare Parts

WA03320A Spare light-guide adapter, Olympus light-guide cable to Olympus light source



OLYMPUS

OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES EUROPE
Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuehnstr. 61
22045 Hamburg, Germany
www.olympus-eoste.eu

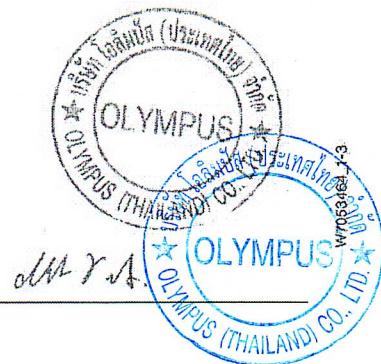


M.Y.A.

3.1.

SK-20-3 : Endoscope instrument case, 37(L)*15(W)*7(H)cm

Operating room

ENDOSCOPE
INSTRUMENT CASE

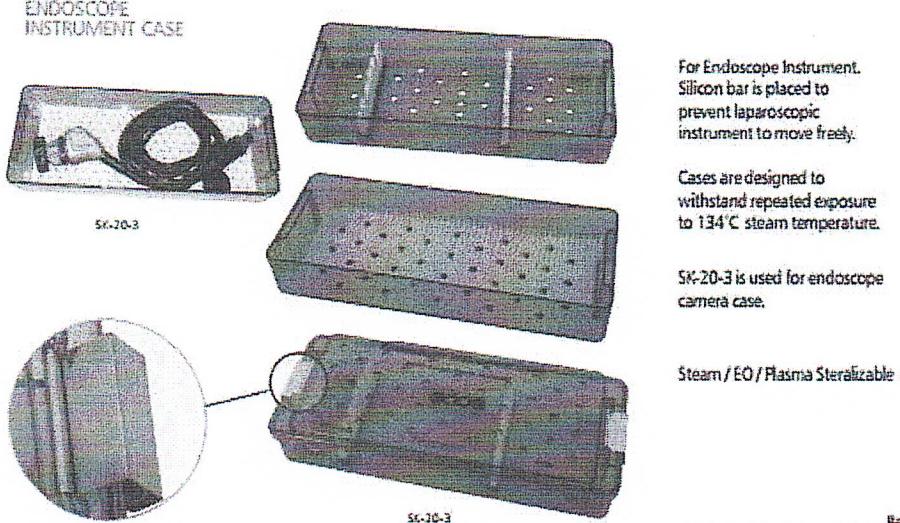

For Endoscope Instrument.
Silicon bar is placed to
prevent laparoscopic
instrument to move freely.


Cases are designed to
withstand repeated exposure
to 134°C steam temperature.

SK-20-3 is used for endoscope
camera case.

Steam / EO / Plasma Sterilizable

SK-20-3 37(L) * 15(W) * 7(H) cm

LAPAROSCOPIC
INSTRUMENT CASE

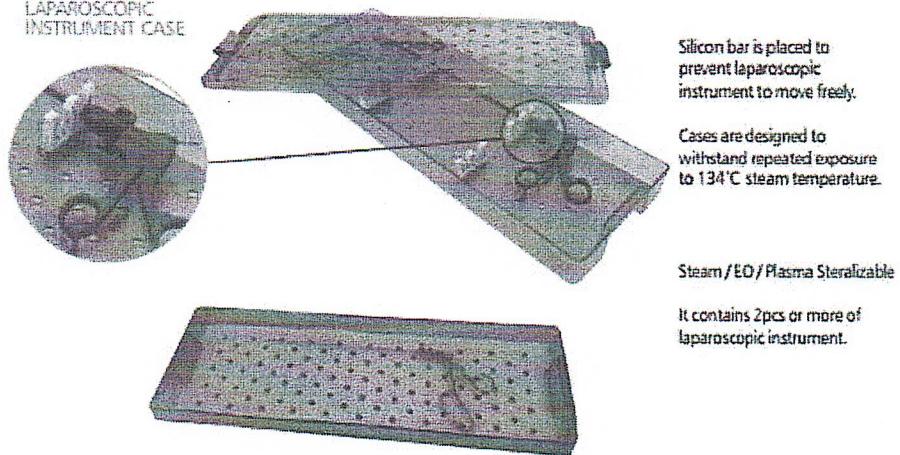

Silicon bar is placed to
prevent laparoscopic
instrument to move freely.

Cases are designed to
withstand repeated exposure
to 134°C steam temperature.

Steam / EO / Plasma Sterilizable

It contains 2pcs or more of
laparoscopic instrument.

SK-20-4 60(L) * 20(W) * 6(H) cm



MM.Y.A.

MM.Y.A.

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายแพทย์เขียวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
จังหวัดสมุทรปราการ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร เดอะ:inline ทาวเวอร์ อาคาร เอ ชั้น ๓๒
เลขที่ ๓๓/๔๘๘๘ พระราม ๙แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๐๐๐-๗๗๐๐ โดย นายมนตรี วรรณาทศน์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ตาม) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดด้วยในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคាត่อ หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	ชุดกล้องสองตัวระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลผลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน์	-	๑ ชุด	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
๒	ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความคมชัดสูง	-	๑ ชุด	๑,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
๓	หัวกล้อง ๕K series	-	๑ ชุด	๑,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๖,๙๕๔,๐๐๐.๐๐	

(หากล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาน้ำเสียง加上เพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจรับคำเสนออนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกใบตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานข้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้
๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับ



ด.๑๑๘.๙.๙

หนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานร้อยละ ๕.๐๐ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาด้านนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด รับหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายได ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่ หรือใบเสนอราคайдี ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด สงวนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายได ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอที่ ข้าพเจ้าขอรับ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคากลางเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธนิชธรรม และปราสาจากกลุ่ม หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕:๔๐:๓๙ น.

(นายมนตรี วรรณาทัศน์)

ผู้รับมอบอำนาจช่วง

เลขที่โครงการ ๖๗๐๔๗๐๙๓๔๕

ใบเสนอราคานี้ที่ ๖๗๐๔๗๖๐๐๑๙๑๗

รหัสอ้างอิง OTP ZMbx

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๔๔๔๒๐๙๐๑๑



MLXAF

ใบต่อรองราคา

ที่ โรงพยาบาลบางพลี

วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ตามที่ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง บริษัท ออลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคา ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารเลขที่ ๒๓/๒๕๖๗ รวม ๑ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้าง ได้ทำการต่อรอง ดังนี้

- () ราคา
(.....) วันส่งมอบของ
(.....) วันยืนยันราคา

๓. ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและบททวนอย่างถี่ถ้วนแล้ว ขอเสนอราคาดังนี้

- (.....) ยืนยันราคาที่เสนอไว้เดิม
() ยินยอมลดราคา โดยรับเสนอราคามาตรฐาน เอกสาร เอกสาร

เลขที่ ๒๓/๒๕๖๗ ในราคาก่อสร้าง

รายการที่ ๓ หัวกอล์ฟ EK series จำนวน ๑ ชุด ลดราคาเป็นเงิน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

และยินดีแคม กล่องใส่เลนส์ จำนวน ๑ กล่อง มูลค่า ๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือราคาที่เสนอไว้ครั้งนี้ จำนวนรวม ๑ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เหมือนเดิมทุกประการ



ลงชื่อ..... *พี. จ. ล.* ผู้เสนอราคา

(..... ม. พ. ๗๗๗๗ ๗๗๗๗ ๗๗๗๗ ๗๗๗๗)
ตำแหน่ง...ผู้จัดการ สำนักงานขายเดือน ๑๘๙๙ กษาฯ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประทับตรา (ถ้ามี)



พี. จ. ล.



Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Registration number/Tax ID. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000

A member of MUFG
a global financial group



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาชื่อ)

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 24/0737

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดย นางสาวพจมาลย์ บุนนาค และ นางสาวกมลวรรณ สังข์เจด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ชื่อ" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท ไออลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย" ได้ทำสัญญาชื่อขายหัวกล้อง 4K series จำนวน 1 ชุด กับผู้ชื่อ ตามสัญญาเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ ซึ่งผู้ขายต้องวง
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ชื่อ เป็นจำนวนเงิน -74,750.00 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่ง
เท่ากับร้อยละห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกวันของผู้ชื่อ จำนวนไม่เกิน -74,750.00 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในการนี้ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญา ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ชื่อไม่จำเป็นต้องเรียกวันให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2569. และข้าพเจ้าจะไม่
เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นฯ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนือกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สำนักงานใหญ่

ลงชื่อ _____

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวพจมาลย์ บุนนาค 11000288)

(นางสาวกมลวรรณ สังข์เจด 11003811)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ _____

เอการ ฉนิลวนิช

(นางสาวศุภานัน พันธ์)

(นางเอการี วินิจฉานิวงศ์)



ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม
หากมิได้รับคืนต้นฉบับโดยเร็ว ภายในห้าวันที่
หนังสือค้ำประกันออกเป็นหน่วย

No. 0814970