

## สัญญาซื้อขาย

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิร่างกาย ตัวนีมวกลาย พร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูล

สัญญาเลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เขียวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลีปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๔๘๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชนต์เมด จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒๒,๒๒๒/๑-๒ อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑ ถนนรัตนาริบอร์ด ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นายอภิชาต อ้วสวัสดิ์เจริญ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ บธ. ๐๐๐๒๑๐ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิร่างกาย ตัวนีมวกลาย พร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูล จำนวน ๓ (สาม) เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๙,๔๓๘.๒๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบ-เก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

### ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า มีการตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

### ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ซื้อทั้งสิ้นข้อ

### ๔ การส่งมอบ...


(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เขียวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายอภิชาต อ้วสวัสดิ์เจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เชนต์เมด จำกัด (มหาชน)

**SAINTMED**  
Saintmed Public Company Limited

#### ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้ง หีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วันทำการของผู้ซื้อ

#### ข้อ ๕ การตรวจสอบ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเข่นว่า ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว


#### ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใน กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลา ดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่าย เองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง นั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบบำรุงค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘ หลักประกัน...


(ลงชื่อ).....  


นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....  


นายอภิชาติ อัสาวิจิตรเจริญ

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เชนต์เมด จำกัด (มหาชน)

**SAINT MED**  
Saintmed Public Company Limited

#### ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่ ๑๐๐๑๖๔๗๗๔๒๖๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคารหั้งหมดตามสัญญา นำมาอปให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครองคลุมความรับผิดทั้งปวง ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบ สิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เปเลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน ครบถ้วนตามวรคหนึ่งนำมาอปให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบลิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิก สัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย จากผู้ขาย

ในการณ์ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย


#### ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในการณ์ที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคารสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญานั้นถ้วนที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ สิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาน้ำที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถ้วนบกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ...

(ลงชื่อ)..... 	ผู้ซื้อ	(ลงชื่อ)..... 	ผู้ขาย
(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)		(นายอภิชาติ อัสวิญเจริญ)	
นายแพทท์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน		ผู้รับมอบอำนาจจาก	
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน		บริษัท เชนต์เมด จำกัด (มหาชน)	
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ		<b>SAINTMED</b>	
		Saintmed Public Company Limited	

### ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

### ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดังที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๕ (สิบท้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว ให้ผู้ซื้อทราบภายใน

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบ...

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นายอภิชาติ อัสวายิ่งเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เชนต์เมด จำกัด (มหาชน)

**SAINTMED**  
Saintmed Public Company Limited

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย จะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาอย่างประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของ โดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ ดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(นายอภิชาติ อัสวิริยะเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เชนต์เมด จำกัด (มหาชน)



(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวสาวยัล รุ่งรัชต์รี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิร่างกาย ด้ชนีมวลกาย  
พร้อมระบบเข้มต่อข้อมูล

**๑. ความต้องการ**

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน น้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิและดัชนีมวลกาย พร้อมส่ง  
เข้าระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อใช้วัดความดันโลหิต น้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิและดัชนีมวลกาย ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ

**๓. คุณลักษณะทั่วไป**

๓.๑ มีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๒ มีเครื่องวัดน้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิและคำนวนดัชนีมวลกาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๓ สามารถเข้มต่อข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของผู้ป่วยผ่านระบบ WiFi หรือ LAN ได้

๓.๔ สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐/๖๐ Hz

**๔. คุณสมบัติทางเทคนิค**

๔.๑ รายละเอียดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

๔.๑.๑ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตโดยไม่ต้องพันผ้ารัดแขน (Cuff) โดยมีช่องสอดแขนเป็น  
แบบวงกลม

๔.๑.๒ สามารถแสดงค่าความดันโลหิต Systolic, Diastolic และชีพจร (Pulse rate)

๔.๑.๓ ใช้เทคนิคการวัดแบบเทคนิคแบบการฟัง หรือ Auscultation Method หรือ  
PlusWave Analysis

๔.๑.๔ สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๐ – ๓๐๐ มิลลิเมตรปอร์ท และ  
สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรในช่วงไม่น้อยกว่า ๔๐ – ๑๘๐ ครั้งต่อนาที

๔.๑.๕ มีค่าความแม่นยำของการวัด ไม่มากกว่า  $\pm 2$  มิลลิเมตรปอร์ท

๔.๑.๖ มีค่าความแม่นยำของชีพจร ไม่มากกว่า  $\pm 2$  %

๔.๑.๗ มีปุ่มสำหรับหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)

๔.๑.๘ สามารถส่งข้อมูลที่วัดได้ไปเข้าเครื่องในรายการที่ ๔.๒ และพิมพ์ผลข้อมูลออกมา  
พร้อมกันได้

๔.๒ รายละเอียดเครื่องวัดดัชนีมวลกาย

๔.๒.๑ สามารถวัดน้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิและคำนวนดัชนีมวลกายได้

๔.๒.๒ มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ชนิด Touch screen ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว  
สามารถแสดง ค่าน้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิและค่าดัชนีมวลกายได้พร้อมกัน

๔.๒.๓ มีระบบ QR / Barcode Scanner และมีระบบอ่านบัตรประชาชน

๔.๒.๔ ตัวเครื่อง...

ลงชื่อ.....*Mo Sir*.....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางมลันดา สนเนชเซลล์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

**SAINT MED**  
Saintmed Public Company Limited

- ๔.๒.๔ ตัวเครื่องมีระบบอ่านบัตรประชาชน  
มีเสียงแนบข้อตอนการใช้งานเป็นภาษาไทย
- ๔.๒.๕ ใช้เทคนิคในการชั่งน้ำหนักแบบ High accuracy load cell สามารถชั่งน้ำหนักได้  
ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑-๒๐๐ กิโลกรัม โดยมีค่าความผิดพลาดของการวัดน้ำหนัก  
ไม่มากกว่า ๑๐๐ กรัม
- ๔.๒.๖ ใช้เทคนิควัดส่วนสูงแบบ Ultrasonic สามารถวัดส่วนสูงได้ในช่วงไม่น้อยกว่า  
๗๐ - ๒๐๐ เซนติเมตร โดยมีค่าความผิดพลาดของการวัดส่วนสูงไม่มากกว่า  
๐.๕ เซนติเมตร
- ๔.๒.๗ ใช้เทคนิคการวัดอุณหภูมิแบบ Infrared โดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย สามารถวัดอุณหภูมิ  
ร่างกายได้ในช่วง ๓๒ - ๔๕ องศาเซลเซียส โดยมีค่าความผิดพลาดของการวัด  
อุณหภูมิไม่มากกว่า ๐.๓ องศาเซลเซียส
- ๔.๒.๘ สามารถพิมพ์ผลข้อมูลที่วัดได้ด้วยระบบ Thermal Printer พร้อมรับข้อมูลจาก  
เครื่องในรายการที่ ๔.๑ มาพิมพ์ผลพร้อมกัน

#### ๕ อุปกรณ์ประกอบ

- |   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| ๕.๑ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ袖อดแขน                       | จำนวน ๑  | เครื่อง         |
| ๕.๒ เครื่องวัดน้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิและคำนวนดัชนีมวลกาย | จำนวน ๑  | เครื่อง         |
| ๕.๓ เก้าอี้สำหรับนั่งวัด                                  | จำนวน ๑  | ชุด             |
| ๕.๔ กระดาษ thermal printer                                | จำนวน ๑๐ | ม้วน ต่อเครื่อง |

#### ๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ รับประกันคุณภาพตัวเครื่อง ๒ ปี
- ๖.๒ เครื่องมือแพทย์ทั้งสองชนิดต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรจากคณะกรรมการ  
อาหารและยา พร้อมแสดงหลักฐาน
- ๖.๓ บริษัทผู้ขายจะต้องเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ได้รับรองการตรวจมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑  
หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ เป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๗. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  
ส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๘. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
- เกณฑ์ราคา
๙. วงเงินงบประมาณที่จะซื้อ  
จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


ลงชื่อ.....*Mo Si*.....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางนลัษดา สนธยาแลล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

# *Height & weight scale*

**SK-L08**

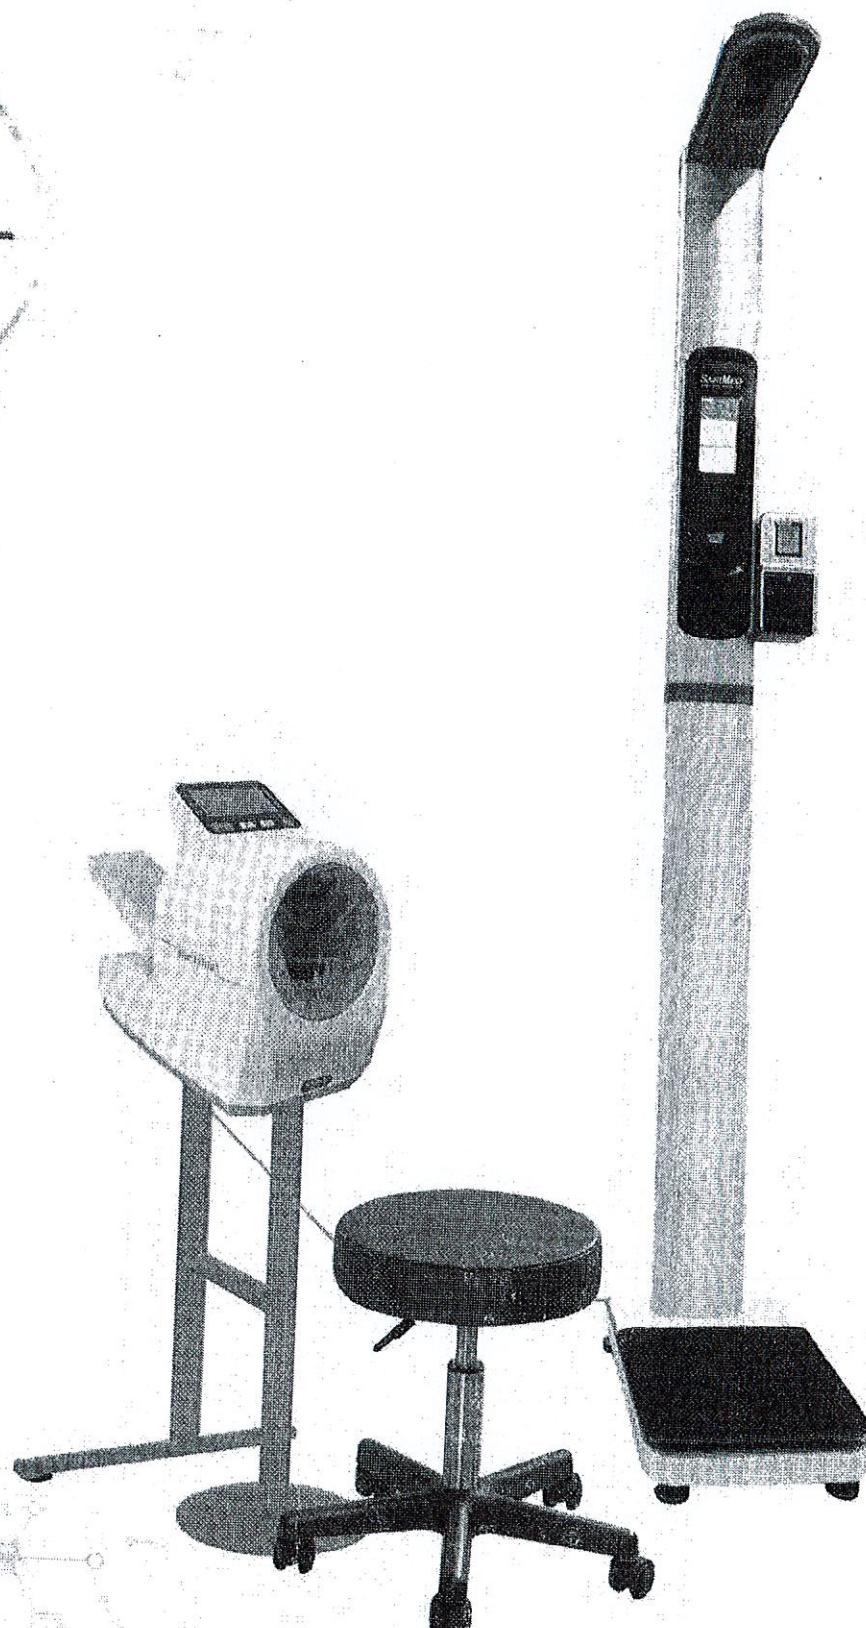




**SAINTMED**  
Saintmed Public Company Limited

# ABOUT HEIGHT&WEIGHT SCALE

Height & weight BMI scale is widely applied in hospitals, clinics, health centers, schools for health screening, it utilizes a ultrasound probe to detect height and a load cell to detect weight, no any manual operation is needed during the process, so it is quite efficient health check machine for large amount of people during the health examination.

## Functions

- 1.7inches touch LCD screen.
- 2.Ultrasonic height probe(70~200cm, accuracy at  $\pm 0.1\text{cm}$ )  
P.S. the height could be customized, MOQ is 20 units.
- 3.Loadcell (1~200kg, accuracy at  $\pm 100\text{g}$ ).
- 4.Automatic BMI calculation.
- 5.Coin acceptor(Support most of countries' coin), could also accept game coin.
- 6.Thermal printer( Any languages can be translated).
- 7.Voice announcement( Any languages can be customized).
- 8.RS232.
- 9.Bluetooth and WIFI function (optional).
- 10.With sphygmomanometer.
- 11.Thai version of the software.
12. Temperature

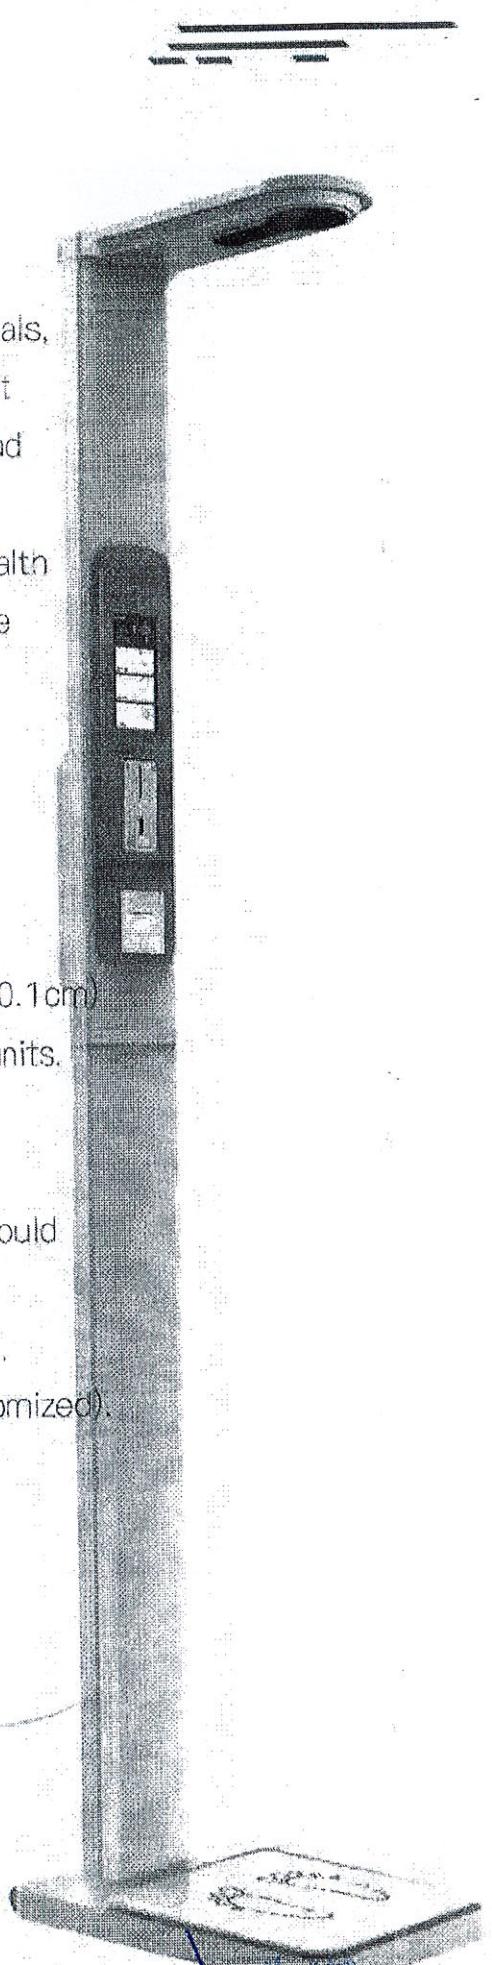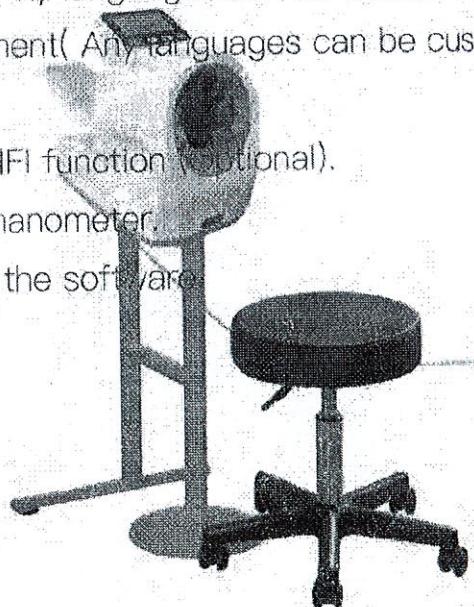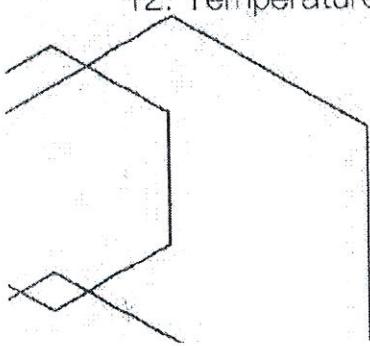

**SAINT NED**  
Saintned Public Company Limited



## Features

- 1.High class industrial designed by European company.
- 2.Material: aluminium and ABS material.
- 3.The scale body is foldable in the middle. Convenient for transportation and installation.
- 4.Data output options: RS232, bluetooth(optional), WIFI(Optional).
- 5.Rechargeable battery, Lithium battery 3V or above (Optional)
- 6.Weight: about 20kg, which is light and portable.
7. 2 wheels under the platform, easy to move.
8. Only 4 screws fixing after your receipt of the goods, which is very easy to install the machine.

## QR/Bar code login/communication

This scale could add inbuilt QR/Bar code scanner and it can scan a QR or Bar code on a wrist band of the patient, so the patient can immediately begin the measurement and the nurse has no further action to record or upload the data to the center, all these jobs can be done through SONKA scale, which is by RS232 or WIFI communication.

P.S. we need your HIS protocol so we know how to transfer the data to your database.

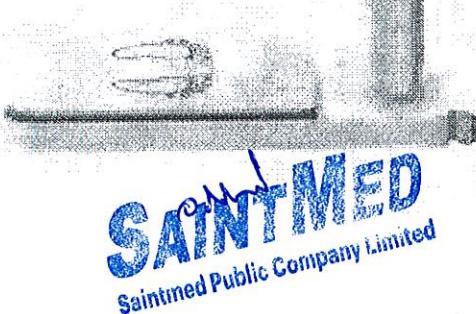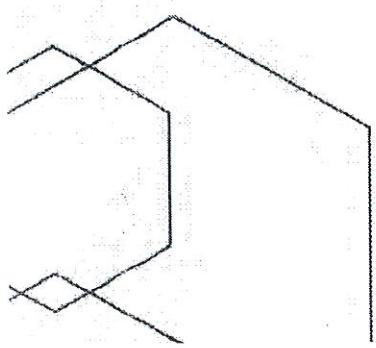

# **ADVANCED HEALTH TRACKING SYSTEM**

SONKA provides a public health monitoring software which could collect all the data from SONKA health check points, so by this software, your local government could know the general health condition of all the public people. This information must be accurate and stored as history data of each person, and this could help government to make new decision on future medical investment and provide professional training courses for needed people.

Sonka device also helps people to track his own personal health history, SONKA health check solution includes height, weight, BMI, blood pressure, ECG, blood glucose, uric acid, total cholesterol, hemoglobin, urine etc., by continuing health data and receiving health advice, people could realize his health condition and adjust this living behaviour.

## Features

Model	SK-I 08
Display screen	7 inches touch LCD screen
Height measurement	Ultrasonic probe
Weight measurement	Resistance high accuracy load cell
Measurement range of height	Height : 70-200cm
Measurement range of weight	Weight: 1-200kg
BMI	Automatic display
Accuracy of height	± 0.1cm
Accuracy of weight	± 100g
Coin machine	Support most countries' coin or game coin
Peak power consumption	< 30W
Standby power consumption	< 8W
Working temperature/Humidity	10-40°C 20-95%
Net weight/package weight	20kg/30kg
Height of machine	229cm
Scale body folding dimension	1152*229*179.4mm
Base foot dimension	621*350*87mm
Package dimension	73*47*131cm
Model	RBP-7000
Measurement Principle	Pulse wave
Display	Backlight LCD display(104*56mm)
Measuring Parts	Left or right hand
Measurement range	0-300mmHg(0-40kPa), SYS 60mmHg-265mmHg, DIA 40mmHg-200mmHg, Pulse rate 40-180/min,
Accuracy	Pressure: ± 2mmHg (±0.267kPa) & Pulse rate: ±2%
Storage Capacity	100 sets
Applicable arm circumference	17cm-42cm
Data Transmission	RS232, USB port
Power Supply	Input: A.C.100-240V, 50-60Hz, 1.6-0.8A Output: D.C.12V, 3.5A
Operating Temperature/Relative Humidity/ Air Pressure	41 °F to 104°F (5°C to 40°C) /15% to 80% RH/80kPa to106kPa
Storage and Transportation Temperature/Relative Humidity/Air pressure	-4 °F to 131 °F (-20 °C to 55 °C) / ≤93%RH/ 50kPa to106kPa
Body temperature measurement method	Infrared Induction
Measurement range	32°C-45°C, Accuracy 0.1°C

Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited.

Factory Address: Floor 6, Block 8, Zhongyuntai Technology Industrial Park, Songbai Road, Shisan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China. 518058

Website: sonkascale.com

Email: sales2010@sonkascale.com

Tel: 0755-33556301/400-048-8836

SAINTMED  
Saintmed Public Company Limited

**SAINTMED**

Advancing Telemedicine. Today.

**บริษัท เย็นเตเมด จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 222/222/1-2 ถนนวงแหวน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 หมู่ที่ 1 อ.วัฒนา เมือง พม่ารักใหญ่ จ.นนทบุรี 11110  
โทร : 0-2527-8075-3, 0-2966-6467-8 โทรสาร : 0-2966-8471 [www.saintmed.com](http://www.saintmed.com) อีเมล : [info@saintmed.com](mailto:info@saintmed.com)

ใบเสนอราคาเลขที่ Q-240617-011-AI

เรื่อง ขอเสนอราคาเครื่องมือแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางพลี

ทางบริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาเครื่องมือแพทย์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย  
โดยมีรายการดังต่อไปนี้

**Sonka**

ที่	รายการ	จำนวน		หน่วยละ	จำนวนเงิน
		3	เครื่อง		
1	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน นำหน้า ส่วนสูง อุณหภูมิและดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS) รุ่น SK-L08 WIFI temp IDcard +Raycorne อุปกรณ์ประกอบ (ต่อเครื่อง) ดังนี้ กระดาษ thermal printer 10 ม้วน			150,000.00	450,000.00

ราคายืนค่า 420,560.75 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 29,439.25 บาท

ราคารวมสุทธิ 450,000.00 บาท

(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ รับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 2 ปีกำหนดส่งของ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อกำหนดยื่นราคา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคาผู้เสนอราคา นายอภิชาติ อัศวะยิ่งเจริญ (ผู้แทนขาย) โทร.088-593-6544

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

**SAINTMED**  
 Saintmed Public Company Limited

(นายเฉลิมลักษณ์ รักษารักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค





ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาชื่อ)

เลขที่ 100069338261

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 19/6 หมู่ที่ 5 ถนนพิบูล  
ส่งคราม ตำบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนonthบุรี จังหวัดนonthบุรี 11000 โดย นางสาว วาสิกา วรารดี (1993) และ นาย ศุภบุตร  
กลันทะบุตร (5471) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้  
ชื่อ” ดังนี้ข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท เชนต์เมด จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขาย เครื่องวัดความดันโลหิต  
แบบสอดแน่น อุณหภูมิร่างกายด้วยมือ พร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูล จำนวน 3 เครื่อง กับผู้ชื่อ ตามสัญญาเลขที่ \_\_\_\_\_  
ลงวันที่ \_\_\_\_\_ ซึ่งผู้ขายต้องวงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ชื่อ เป็นจำนวนเงิน 22,500.00 บาท  
(สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ชื่อ จำนวนไม่เกิน  
22,500.00 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในการณ์ที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายได้ฯ หรือต้อง<sup>รับ</sup>  
ชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายได้ฯ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ชื่อไม่จำเป็นต้อง<sup>รับ</sup>  
เรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570  
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้  
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

( นางสาว วาสิกา วรารดี (1993) )

ผู้ค้ำประกัน

( นาย ศุภบุตร กลันทะบุตร (5471) )

ลงลายมือชื่อ

( นางสาว สาวิตรี มาลีห้อม (3946) )

พยาน ลงลายมือชื่อ

พยาน

( นางสาว อรุณัย งามแม้น )



การอ่านหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่ง<sup>ไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปรับ</sup> งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบางใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนonthบุรี 11120

SR-806000309050-1-1 :-

ไทย/BKCONNECT LG

2480561

K-Contact Center 02-8888888  
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

SAINT MED  
Saintned Public Company Limited  
EE-0-2.NN\_PLUS  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000315