

สัญญาซื้อขาย  
เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer เคลื่อนที่)

สัญญาเลขที่...๑๓๘.../๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๔๘๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔๖ อาคารรัชดาวัน ชั้นที่ ๗ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นายสุรศักดิ์ ไพราม ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๔๖๖๙๒๙ ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer เคลื่อนที่) จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๒,๘๘๗.๒๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ตลอดจนภาษี อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๖ (หก)	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ซื้อทั้งสิ้น



SEI Medical Public Company Limited  
บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)  
๔ การสั่งมอบ...

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายสุรศักดิ์ ไพราม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

**ข้อ ๔ การส่งมอบ**

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ .....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วันทำการของผู้ซื้อ

**ข้อ ๕ การตรวจรับ**

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

**ข้อ ๖ การชำระเงิน**

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

**ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๓ (สาม) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



SEI Medical Public Company Limited  
บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)  
ข้อ ๘ หลักประกัน...

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไข่มพริ้วสถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นายสุรศักดิ์ ไพราม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

#### ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ LG๐๑-๐๐๘๔๙/๒๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

#### ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



SEI Medical Public Company Limited  
บริษัท เอสไอเ็มดี จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไขทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายสุรศักดิ์ ไพราม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เอสไอเ็มดี จำกัด (มหาชน)

### ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อ มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

### ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



SEI Medical Public Company Limited  
บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)  
ในการส่งมอบ...

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไซทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายสุรศักดิ์ ไพราม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไข่มุกข์สถาพร)


นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ภูมิตวีราการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย


(นายสุรศักดิ์ ไพราม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก  
บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวสายชล ธีฤทธิ์ตรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  
เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer เคลื่อนที่)

๑. ความต้องการ

เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์

ใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด ให้ความอบอุ่นและไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงขณะรับการรักษา

๓. ลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดชนิดให้รังสีความร้อนด้วย Radiant Warmer

๓.๒ มีชุดควบคุมการทำงานพร้อมเตียงและฐานรองรับทารกซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับเด็กได้พร้อมกัน  
สูงสุด ๒ คน

๓.๓ สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแบบ Radiant Warmer โดยมีชุดทำความร้อนชนิด Ceramic Heater Elements  
พร้อมด้วย Golden Reflectors เพื่อช่วยกระจายความร้อนสู่เบาะรองรับทารกได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๓.๒ มีระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก (Skin Mode) หรือแบบควบคุมอุณหภูมิโดยการตั้งค่าของ  
Heater (Manual Mode)

๓.๒.๑ Skin Mode สามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๓๕ - ๓๗.๕ °C

๓.๒.๒ Manual Mode สามารถปรับเลือกระดับความร้อนได้ ๑๐ ระดับ โดยในระดับที่ ๓ สามารถให้  
ความร้อนได้เป็น ๑๐ mW/cm<sup>๒</sup> ในระดับที่ ๑๐ สามารถให้ความร้อนได้เป็น ๓๐ mW/cm<sup>๒</sup>

๓.๓ มีหลอดไฟ Halogen Lamp ควบคุมการให้แสงสว่างเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา โดยให้ความสว่างได้ ๒ รูปแบบ  
คือ Work light ๓๐ W และ Night light ๙ W

๓.๔ ชุดควบคุมความร้อน SmartSWIVEL ช่วยในการ Focus ความร้อนให้กับทารกกรณีที่ต้องหัน Warmer  
ไปทางด้านอื่นเพื่อ X-ray และผลักออกไปด้านข้างไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา

๓.๕ อุณหภูมิที่วัดได้แสดงเป็นตัวเลข Digital LED

๓.๖ ระยะความสูงระหว่าง Radiant Warmer กับเตียงประมาณ ๘๐ เซนติเมตร

๓.๗ สามารถปรับระดับของเตียงและเบาะเด็กด้านศีรษะขึ้นได้ ๒๐ องศาหรือปรับลงได้ ๑๕ องศา

๓.๘ แผงกันเตียง ๔ ด้าน ทำด้วยวัสดุใส สามารถพับลงได้ ๓ ด้านเพื่อความสะดวกในการทำหัตถการ และมีผนังชั้นใน  
๒ ด้านความสูง ๗ เซนติเมตรเพื่อป้องกันเด็กตกจากเตียงในขณะที่พับแผงกันเตียงลง


๓.๙ ระบบสัญญาณเตือนแสดงเป็นข้อความและเสียง

๓.๙.๑ อุณหภูมิที่ผิวหนังสูงกว่า ๓๙ องศาเซลเซียส

๓.๙.๒ สายวัดอุณหภูมิที่ผิวหนังหลุดหรือชำรุด

๓.๙.๓ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

๕. อุปกรณ์...

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสาวยุวรี กลิ่นเกษร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕. อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑ Skin Temperature Probe (Core และ Peripheral)	จำนวน ๒ เส้น
๕.๒ เฆาะนอน	จำนวน ๑ ชุด
๕.๓ รถเข็นวางเตียงและชุดให้ความอบอุ่น	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔ คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	อย่างละ ๑ เล่ม

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ รับประกันเครื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๖.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หากเครื่องมือมีการชำรุดขัดข้องและซ่อมด้วยปัญหาความผิดปกติของเครื่องมากกว่า ๓ ครั้งใน ๓ เดือนแรก บริษัทต้องเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่ให้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อกำหนด
- ๖.๓ ภายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายจะต้องทำการการตรวจสอบเช็คสภาพเครื่อง และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุก ๆ ๖ เดือน
- ๖.๔ ผู้ขายจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงาน มาทำการสาธิตการใช้งานเครื่องและการดูแลรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนใช้งานได้เป็นอย่างดี
- ๖.๕ มีหนังสือรับรองอะไหล่สำหรับซ่อมและบริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันแจ้งยกเลิกการผลิต
- ๖.๖ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
- ๖.๗ กรณีที่เครื่องมือมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายต้องให้บริการตรวจสอบ พร้อมเปลี่ยน อะไหล่ฟรี ในระหว่างการรับประกัน และต้องมีเครื่องสำรองมาให้ระหว่างซ่อม
- ๖.๘ ผู้ขายต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนว่าเครื่องที่นำเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบ specification

๗. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ


ส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณที่จะซื้อ

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสาวยุวรี กลิ่นเกษร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

# Optimum warmth



SEI Medical Public Company Limited  
บริษัท เอสอีไอ แพดดิเคิล จำกัด (มหาชน)



## ... So your little patients prosper

The latest generation of BabyTherm infant warming systems from Dräger sets new standards in open care – not only in providing newborn babies with a unique thermal environment, but also in ensuring you enjoy outstanding ease of access so you can give them the best possible care.

### SMARTSWIVEL FOR FOCUSED WARMTH

The smartSWIVEL mechanism featured in the BabyTherm 8004 and 8010 models automatically focuses radiant warmth on the baby, even if the radiant heater is moved to one side. As a result, you don't need to worry about the baby cooling down or suffering cold stress during X-rays or other procedures because you can be sure of even radiant heat distribution at all times.

### EVEN SPREAD OF HEAT



The BabyTherm's ceramic heater elements and golden reflectors provide even heat distribution over the entire bed area. So wherever you place the baby on the bed, your little patient will always feel comfortably warm.

### EARLY-WARNING THERMOMONITORING™


Measuring a baby's central and peripheral (toe) temperature gives you an early warning of thermal instability or possible cold stress. The BabyTherm 8004 and 8010 offer you continuous monitoring of both temperatures, enabling you to detect thermal stress at an early stage, by observing the measured values on the integrated digital display. The measurement data can be optionally downloaded via an RS 232 interface to a monitor or PC.

### THE COMFORT OF A WARM GEL MATTRESS

The soft feel and soothing comfort of the actively heated gel mattress, that comes standard with the BabyTherm 8000\* and 8010, add to the controlled thermal environment to make your little patient feel considerably more comfortable. By using the heated gel mattress, you can reduce the output from the radiant heater, which in turn reduces insensible water loss. In addition, the combination of conductive warmth from the heated gel mattress and radiant warmth from the overhead heater enables you to warm up cold babies quickly.

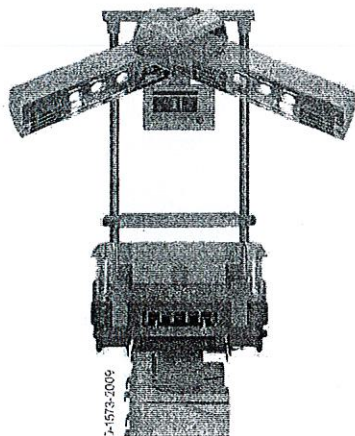

The intuitive control panel features clear text messages to provide you with all the necessary information.

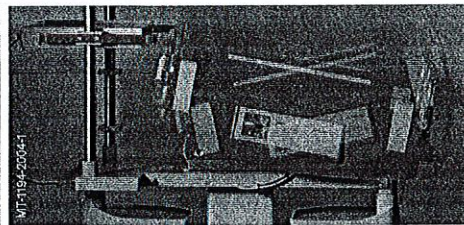

The smooth bed lill can be adjusted between 20° down and 15° up.

The combination of conductive warmth from the heated gel mattress and radiant warmth from the overhead heater enables you to warm up cold babies quickly.

# Optimum ergonomics

## ... So you enjoy easy access

We care about ergonomics because you want to give your little patients the best possible care. That's why the BabyTherm series is designed to allow you to work under ideal ergonomic conditions. In practical terms, this translates into optimum ease of access and the sensible arrangement of all control or display features.

### SMARTSWIVEL® FOR MORE SPACE

The patented smartSWIVEL® mechanism on the BabyTherm 8004 and 8010 is not only good for the baby, it also provides you with more working space, easier access to the baby and a more comfortable working environment because you don't have to work right underneath a radiant heater and are therefore not exposed to the radiant heat.

### CONVENIENT CONTROL PANEL

The control panel positioned directly beneath the radiant warmer is easy to reach so you can adjust the settings with no trouble at all. Another advantage is that you will easily be able to read all the essential information on the large, bright digital display from any position around the bed.

### EASY-TO-SPOT ALARM

The bright red central warning light at the end of the radiant warmer will alert you to an alarm condition even if you are working with another baby or in a different part of the room. A clear text message then provides you with all the details you require.


### EASE OF USE

Our efforts to ensure you enjoy the best possible working conditions are reflected in a number of practical features. The height of a BabyTherm can be adjusted to suit your height, swivel cupboards are available to give you extra storage space for accessories and all the moving parts or control functions are easy to handle.

### JUST THE RIGHT LIGHTS

A quartz halogen phototherapy system integrated into the overhead housing on the BabyTherm 8004 and 8010 enables you to instantly administer high output phototherapy without using up any valuable footspace.

The examination lamp features settings for day and night. Two brightness levels provide just the right lighting anytime.

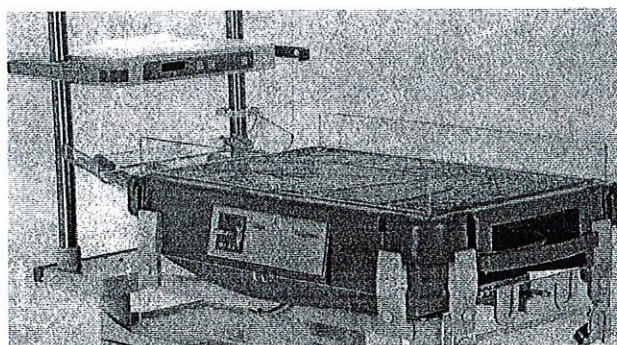

**The BabyTherm Series**

The BabyTherm series is made up of three models – an infant warming system providing radiant heat (BabyTherm 8004), an infant warming system providing radiant and conductive heat (BabyTherm 8010) and a warming bed providing conductive heat (BabyTherm 8000\*). No matter which BabyTherm you choose, you can be sure of giving your little patients the best possible care.




SEI Medical Public Company Limited  
บริษัท เอสอีไอ เพดดิคัล จำกัด (มหาชน)

\*Babytherm 8000 is not available in the USA.


# Optimum options



SEI Medical Public Company Limited  
บริษัท เสอีโอดี แพดเคิล จำกัด (มหาชน)

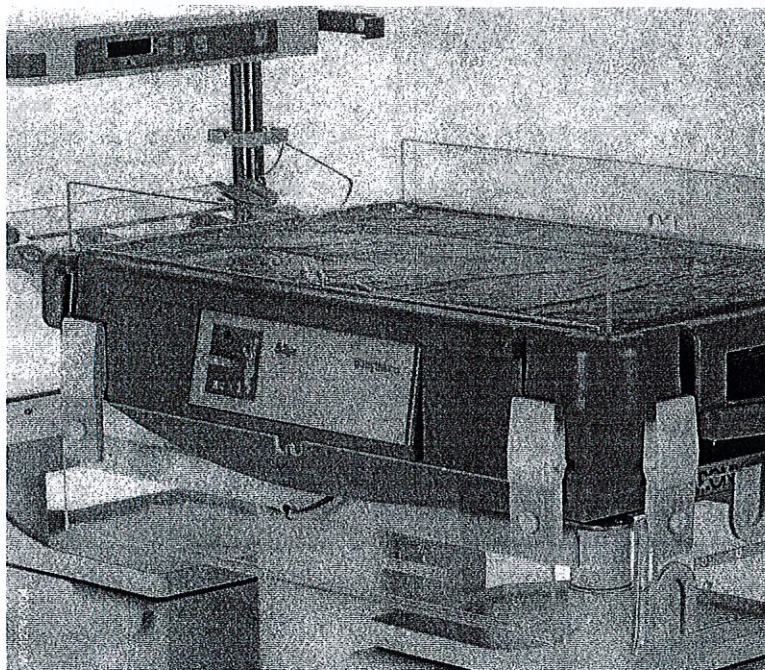

All four side panels can be folded down with a singlehand action to provide complete access. You can choose a panel height of 15 cm or 23 cm.

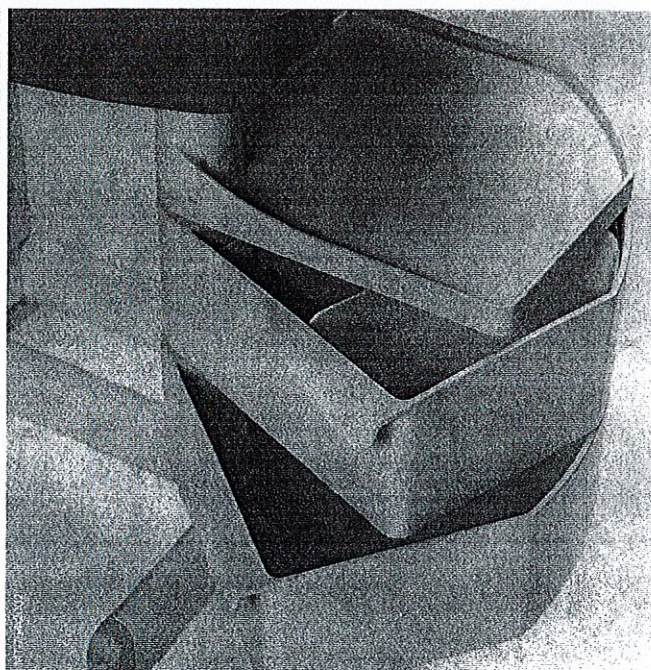

The swivel drawers provide plenty of space for storage.

BABYTHERM	8010	8004	8000*
<b>STANDARD FEATURES</b>			
SmartSWIVEL® mechanism	•	•	
Manual mode	•	•	
Skin servo mode	•	•	
Bright and soft light	•	•	
Central Alarm	•	•	
ThermoMonitoring™	•	•	
Text messages	•	•	
Bed tilt	•	•	•
Inner side walls (7 cm)	•	•	•
Heated gel mattress	•		•
X-ray tray	•	•	
<b>OPTIONS</b>			
Integrated phototherapy	•	•	
Height adjustment	•	•	•
RS232 interface	•	•	
Storage Drawers	•	•	•
Stand alone Phototherapy			•



SEI MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED  
No. 546 Ratchada One Building, 7th Fl,  
Ratchadaphisek Road, Chankasem, Chatuchak,  
Bangkok Thailand 10900

E-MAIL : INFO@SEI.CO.TH  
PHONE : +66 (2) 561 3691 -3  
www.sei.co.th

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 546 อาคารรัชดาวัน ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
10900

เลขที่ผู้เสียภาษี 0107566000607 (สำนักงานใหญ่)  
แฟกซ์: 02 561 3694

## ใบเสนอราคา

เลขที่ QNeo-670638

วันที่ 13/6/2567

เรื่อง ขอเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
เรียน ผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลบางพลี

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) ขอเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ Draeger ประเทศเยอรมนี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวมภาษี (บาท)
1	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด รุ่น Babytherm 8004	1 เครื่อง	400,000.00	400,000.00

มูลค่าสินค้ารวมภาษี	400,000.00
มูลค่าสินค้า	327,102.80
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	22,897.20
ส่วนลดพิเศษ	50,000.00
ราคาสินค้า	350,000.00

สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

### หมายเหตุ

กำหนดยื่นราคา 120 วัน

กำหนดส่งสินค้า 150 วัน

รับประกันคุณภาพ 1 ปี - เดือน

เงื่อนไขการชำระเงิน 120 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
คุณสุรศักดิ์ ไพราม  
ผู้แทนขาย  
063-774-4699



SEI Medical Public Company Limited  
บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(ณิชากานต์ ชานาญ)

ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกทารกแรกเกิด



SEI Medical Public Company Limited  
บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาซื้อ)  
(กรณีปกติ)

เลขที่ LG01-00849/24

วันที่ 26 สิงหาคม 2567

ข้าพเจ้าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยนางสาวศิริส แสงภู และนายจุมพล พิพัฒน์ศุภากร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลบางพลี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Warmer เคลื่อนที่) จำนวน 1 เครื่อง กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่ ..... ลงวันที่ ..... ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน 17,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จำนวนไม่เกิน 17,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้ดังกล่าวก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ค้ำประกัน  
(นางสาวศิริส แสงภู) (นายจุมพล พิพัฒน์ศุภากร)  
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนหนังสือค้ำประกันและรับประกันการส่งออก ผู้จัดการ ส่วนหนังสือค้ำประกันและรับประกันการส่งออก

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวหนึ่งฤทัย ที่พิมาย)

ส่วนหนังสือค้ำประกันและรับประกันการส่งออก ฝ่ายธุรกิจธนาคาร  
โทร. 0 2169 9999 ต่อ 1540-9